

Tips og Tricks



Printerindstillinger

Printerindstillinger:

- <https://smds.dk/faq/>

- Jeg har problemer med at printe

Tekst og etiketter rammer ikke korrekt på blanketten.


Sideopsætningen kan indstilles manuelt.

Brug denne vejledning:

Opsætning så tekst og etikette rammer korrekt i Chrome eller Edge

Opsætning til print af PTB'er

Printerindstillinger:

Praksis	
Patient	Muhammed Abdul, 100705-9995 (n) 16 år

REDIGER PRAKSIS STAMDATA

Navn	Synlab support only
Adresse	Odeons kvarter 19
Postnr	5000
Bynavn	Odense
Tlf.	12121212
Email	
Ydemr	990104
Lokationsnummer	5790002405396
Del gemte rekvisitioner med	
Del egne profiler med	
Databehandleraftaler	Version 1.3 d. 18-03-22 kl. 08:04:49 (ZE) <input type="button" value="Se aftale"/>
Klinikadministratorer	<input type="button" value="v"/>
Print venstre margin	8
Print top margin	6
Aftale med patient (Tilbagesvar)	Patienten skal have svar <input type="button" value="v"/>
Web-Patient overvågning (Tilbagesvar)	Ingen overvågning <input type="button" value="v"/>

Edge og Chrome

Skal rettes på brugerniveau

Print venstre margin: 8

Print top margin: 6

Printerindstillinger Chrome:

Sideopsætning til Chrome:

Klik på de tre prikker i øverste til højre-> vælg **Udskriv** og klik på **Flere** indstillinger.



Fig. Opsætning markeret med rød er vigtig. Hvor der ikke er sat flueben, skal der ikke være noget.

Udskriv 4 ark papir

Destination HP7D83D6 (HP Color I)

Sider Alle

Kopier 1

Layout Stående

Farve Farve

Flere indstillinger

Papirstørrelse A4

Sider pr. ark 1

Margener Standard

Skaler Standard

Tosidet Udskriv på begge sider

Valgmuligheder Sidehoveder og -fodder

Baggrundsgrafik


Printerindstillinger Edge:

Sideopsætning til EDGE:

Printer HP7D83D6 (HP Color LaserJet ...	Papirstørrelse A4	
Kopier 1	Skaler (%) 100	
Layout <input checked="" type="radio"/> Stående <input type="radio"/> Liggende	Sider pr. ark 1	
Sider <input checked="" type="radio"/> Alle <input type="radio"/> f.eks. 1-5, 8, 11-13	Margener Brugerdefineret	
Farve Farve	Øverst 10mm	Nederst 122mm
Udskriv på begge sider Udskriv på én side	Venstre 10mm	Højre 10mm
Flere indstillinger	Indstillinger <input type="checkbox"/> Sidehoveder og sidefodder <input type="checkbox"/> Baggrundsgrafik	

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen

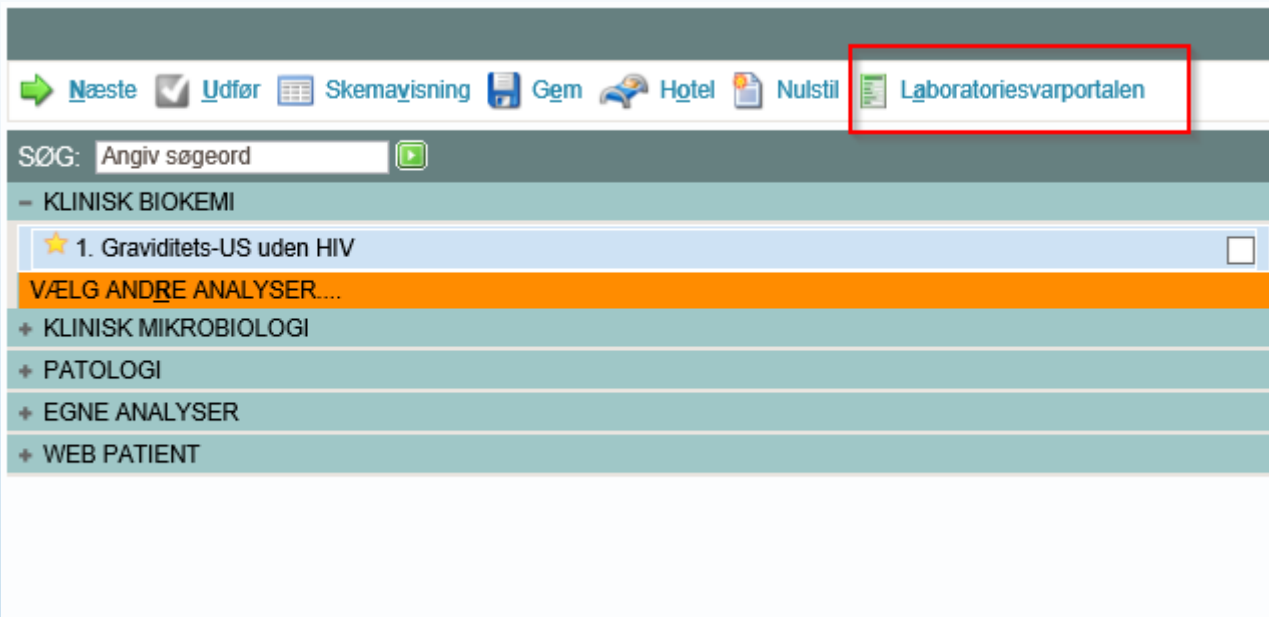

The screenshot shows the SYNLAB Laboratoriesvarportalen interface. At the top, there is a navigation bar with several icons and labels: a green arrow for 'Næste', a checkmark for 'Udfør', a calendar for 'Skema~~v~~isning', a floppy disk for 'Gem', a globe for 'Hotel', a document for 'Nulstil', and a document with a green checkmark for 'Laboratoriesvarportalen', which is highlighted with a red box. Below the navigation bar is a search bar labeled 'SØG:' with the placeholder text 'Angiv søgeord' and a green play button icon. The main content area is a list of categories, each with a plus sign on the left and a minus sign on the right. The categories are: 'KLINISK BIOKEMI' (with a minus sign), '1. Graviditets-US uden HIV' (with a star icon and a checkbox), 'VÆLG ANDRE ANALYSER...' (highlighted in orange), 'KLINISK MIKROBIOLOGI', 'PATOLOGI', 'EGNE ANALYSER', and 'WEB PATIENT'.

Næste Udfør Skema~~v~~isning Gem Hotel Nulstil **Laboratoriesvarportalen**

SØG: Angiv søgeord

- KLINISK BIOKEMI

★ 1. Graviditets-US uden HIV

VÆLG ANDRE ANALYSER...

+ KLINISK MIKROBIOLOGI

+ PATOLOGI

+ EGNE ANALYSER

+ WEB PATIENT

Laboratoriesvarportalen

g/L							
mmol/L							
mmol/L							

mmol/l							
kPa							
kPa							

Meddelelse fra webside

Ønsker du at sende kun de markerede analyseresultater?

OK Annuller

Send de markerede svar til dit journalsystem.

Du skal angive hvor vi skal sende til. Du skal udfylde EDI-lokationsnummer og ydernummer eller SKS-kode. Vi sender via EDI, hvorefter du kan importere på vanlig vis i dit lokale journalsystem.

EDI-lokationsnummer:
5790000120414 *

Ydernummer:
(kun lægepraksis)
123456


SKS-kode:
(kun sygehuse)

Tilbage til oversigt

Send

Laboratoriesvarportalen

Hvor finder man ydernummer og lokationsnummer?

Praksis	 WebReq test læge (123456), mm
Patient	Nancy Berggren, 251248-9996 (n) 73 år

REDIGER PRAKSIS STAMDATA	
Navn	WebReq test læge
Adresse	Storhaven 1
Postnr	4200
Bynavn	slagelse
Tlf.	75720177
Email	
Ydernr	123456
Lokationsnummer	5790000121526
Del gemte rekvisitioner med	990104
Del egne profiler med	990104
Databehandleraftaler	Version 1.3 d. 04-12-19 kl. 11:13:12 (mm) <input type="button" value="Se aftale"/>
Klinikadministratorer	Zita Elbæk <input type="button" value="v"/>
Print venstre margin	8
Print top margin	6
Aftale med patient (Tilbagesvar)	Patienten skal have svar <input type="button" value="v"/>
Web-Patient overvågning (Tilbagesvar)	Ingen overvågning <input type="button" value="v"/>

Seneste svar

Se seneste svar

REKVISITION: LABORORIEMEDICIN

Udfør Skema-visning Gem Hotel Nulstil Laboratoriesvarportalen **Seneste svar**

SØG:

- KLINISK BIOKEMI

- HÆMATOLOGI

- Folat;P
- Haptoglobin;P
- Jern;P
- Methylmalonat;P
- Transferrin;P
- Vitamin B12;P
- Eosinofilytter;B
- Erythrocytter;B
- Erythrocytv. rel. spredning;Erc(B)
- Erythrocytvolumen (middel) [MCV];B
- Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)

☆ ● Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)

☆ ● Haptoglobin;P

☆ ● Jern;P

☆ ● Hæmoglobin [MCHC];Erc(B)

GEN	< 0.1 ↓	g/l	14.02.22
GEN	25	µmol/l	25.03.22
GEN	cancelled	mmol/L	07.03.22

Spørgsmål?

